


Mẫu nhãn sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam

(Các mã sản phẩm đều có chung cấu trúc nhãn như nhau, chỉ khác nhau về model, các thông số liên quan)

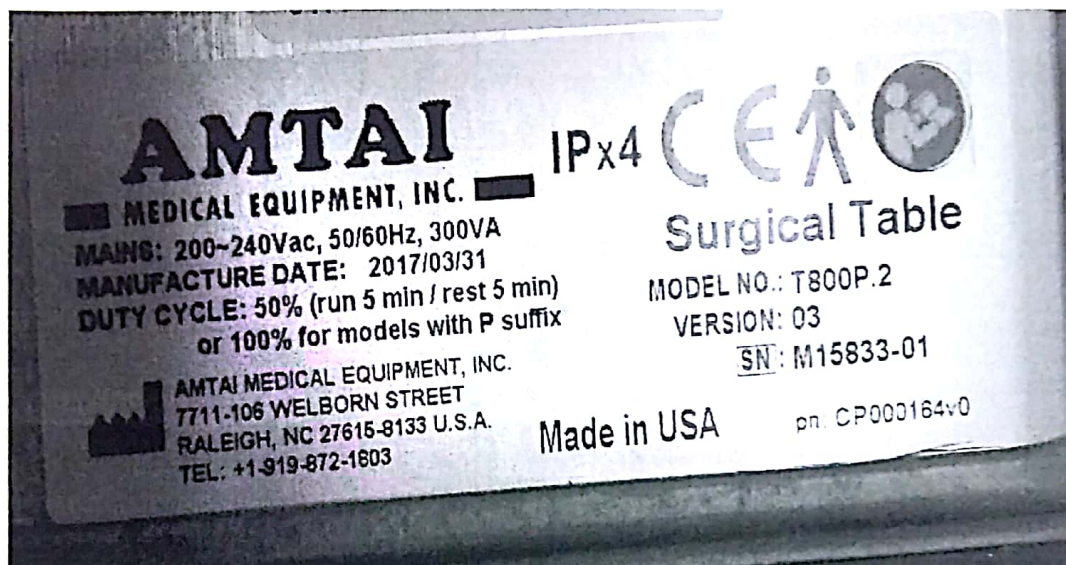

Diễn giải bằng tiếng Việt:

AMTAI

MEDICAL EQUIPMENT INC

Nguồn điện: 200-240 Vac, 50/60Hz, 300VA

Ngày sản xuất: 31/03/2017

Chu trình: 50% (chạy 5 phút/ nghỉ 5 phút)
hoặc 100% với các model có chức năng P
(bàn đạp chân)

Amtai Medical Equipment, INC
7711-106 Welborn street
Raleigh, NC 27615-8133 Mỹ)
Tel: +1-919-872-1803

SẢN XUẤT TẠI MỸ

IPx4 CE

Bàn mổ

Model: T800P.2

Thế hệ: 03

Số seri: M15833-01

pn CP000164v0

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIAM ĐỐC

Lê Thị Thu Hà