




## NHÃN PHỤ

<i>Tên hàng hóa:</i>	<b>Máy phân tích điện giải- EasyLyte</b>
<i>Mã sản phẩm:</i>	2004
<i>Số seri:</i>	.....
<i>Số lưu hành:</i>	.....
<i>HDSD tiếng Việt:</i>	Xem tài liệu HDSD đi kèm
<i>Cảnh báo thận trọng và các thông tin khác:</i>	Đề nghị xem trong HDSD
<i>Nhà phân phối và bảo hành tại Việt Nam:</i>	<b>Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba</b>
<i>Địa chỉ:</i>	Số 56- Ngõ 236 Khương Đình- Hạ Đình- Thanh Xuân- Hà Nội
<i>Nhà sản xuất (chủ sở hữu):</i>	<b>Medica Corporation</b>
<i>Địa chỉ:</i>	3 Oak Park Drive Bedford, MA 01730, USA
<i>Xuất xứ:</i>	Mỹ

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**



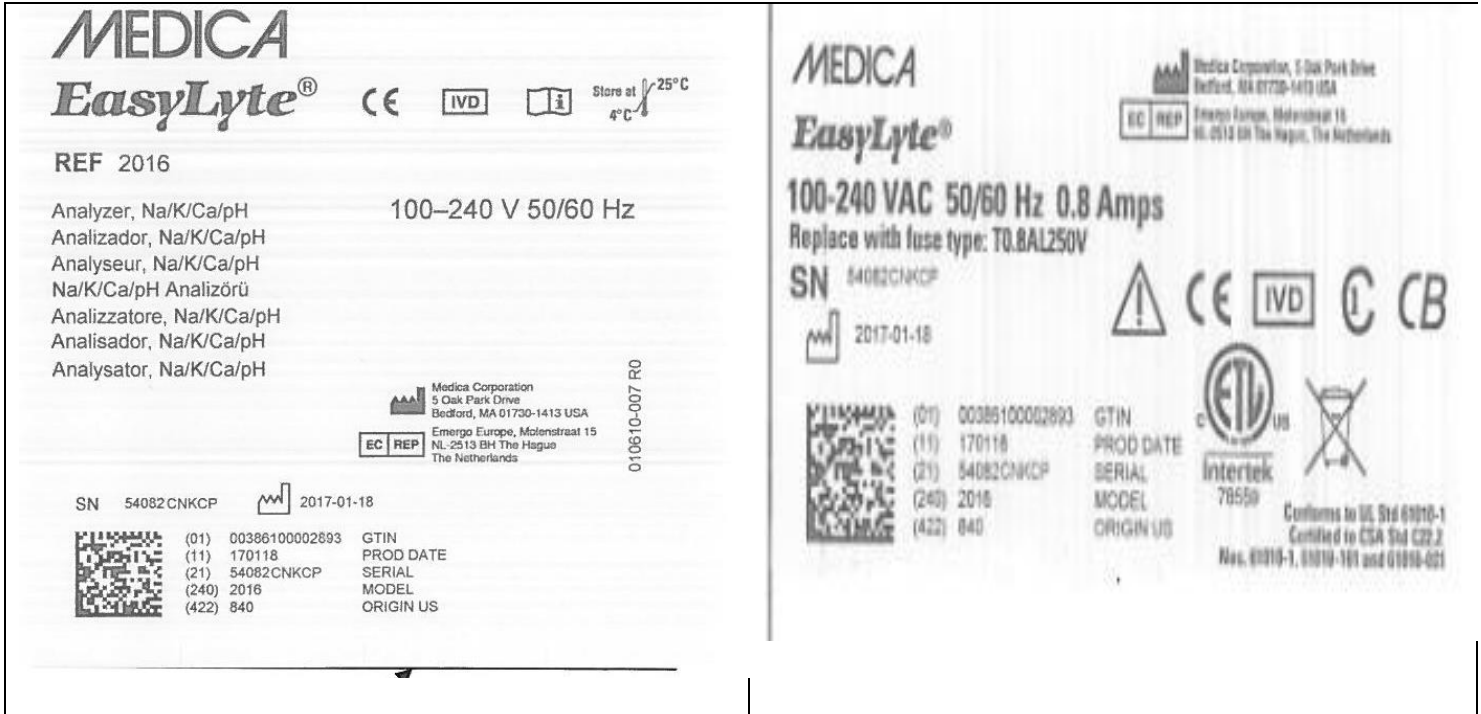

## NHÃN PHỤ

<p><i>Tên hàng hóa:</i></p> <p><i>Mã sản phẩm:</i></p> <p><i>Số seri:</i></p> <p><i>Số lưu hành:</i></p> <p><i>HDSD tiếng Việt:</i></p> <p><i>Cảnh báo thận trọng và các thông tin khác:</i></p> <p><i>Nhà phân phối và bảo hành tại Việt Nam:</i></p> <p><i>Địa chỉ:</i></p> <p><i>Nhà sản xuất (chủ sở hữu):</i></p> <p><i>Địa chỉ:</i></p> <p><i>Xuất xứ:</i></p>	<p><b>Máy phân tích điện giải- EasyLyte</b></p> <p>2016</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Xem tài liệu HDSD đi kèm</p> <p>Đề nghị xem trong HDSD</p> <p><b>Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba</b></p> <p>Số 56- Ngõ 236 Khương Đình- Hạ Đình- Thanh Xuân- Hà Nội</p> <p><b>Medica Corporation</b></p> <p>3 Oak Park Drive Bedford, MA 01730, USA</p> <p>Mỹ</p>
--	--

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**



<p><b>MEDICA</b> <b>EasyLyte®</b></p> <p>REF 2030</p> <p>Analyzer, Na/K/Cl/Ca/Li Analizador, Na/K/Cl/Ca/Li Analyseur, Na/K/Cl/Ca/Li Na/K/Cl/Ca/Li Analizörü Analizzatore, Na/K/Cl/Ca/Li Analizador, Na/K/Cl/Ca/Li Analysator, Na/K/Cl/Ca/Li</p> <p>100-240 V 50/60 Hz</p> <p>Store at 25°C 4°C</p> <p>Medica Corporation 5 Oak Park Drive Bedford, MA 01730-1413 USA</p> <p>Emergo Europe, Molenvstraat 15 NL-2513 BH The Hague The Netherlands</p> <p>SN 54083CNKC 2017-01-09</p> <p>GTIN PROD DATE SERIAL MODEL ORIGIN US</p>	<p><b>MEDICA</b> <b>EasyLyte®</b></p> <p>100-240 VAC 50/60 Hz 0.8 Amps Replace with fuse type: T0.8AL250V</p> <p>SN 54083CNKC</p> <p>2017-01-09</p> <p>Medica Corporation, 5 Oak Park Drive Bedford, MA 01730-1413 USA Emergo Europe, Molenvstraat 15 NL-2513 BH The Hague, The Netherlands</p> <p>GTIN PROD DATE SERIAL MODEL ORIGIN US</p> <p>Intertek 78559 Conforms to UL Std 61010-1 Certified to CSA Std C22.2 Nos. 61010-1, 61010-101 and 61010-001</p>
---	--

## NHÃN PHỤ

<p>Tên hàng hóa:</p> <p>Mã sản phẩm:</p> <p>Số seri:</p> <p>Số lưu hành:</p> <p>HSDS tiếng Việt:</p> <p>Cảnh báo thận trọng và các thông tin khác:</p> <p>Nhà phân phối và bảo hành tại Việt Nam:</p> <p>Địa chỉ:</p> <p>Nhà sản xuất (chủ sở hữu):</p> <p>Địa chỉ:</p> <p>Xuất xứ:</p>	<p><b>Máy phân tích điện giải- EasyLyte EXPAND</b></p> <p>2030</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Xem tài liệu HSDS đi kèm</p> <p>Đề nghị xem trong HSDS</p> <p><b>Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba</b></p> <p>Số 56- Ngõ 236 Khương Đình- Hạ Đình- Thanh Xuân- Hà Nội</p> <p><b>Medica Corporation</b></p> <p>3 Oak Park Drive Bedford, MA 01730, USA</p> <p>Mỹ</p>
---	---

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**



<p><b>MEDICA</b> <b>EasyLyte®</b></p> <p>REF 2015</p> <p>Analyzer, Na/K/Li Analizador, Na/K/Li Analyseur, Na/K/Li Na/K/Li Analizörü Analizzatore, Na/K/Li Analizador, Na/K/Li Analysator, Na/K/Li</p> <p>100-240 V 50/60 Hz</p> <p>Store at 25°C 4°C</p> <p>Medica Corporation 5 Oak Park Drive Bedford, MA 01730-1413 USA</p> <p>Emergo Europe, Molenstraat 15 NL-2513 BH The Hague The Netherlands</p> <p>010610-006 R0</p> <p>SN 54086CNKC</p> <p>2017-01-09</p> <table border="0"> <tr><td>(01)</td><td>00386100002886</td><td>GTIN</td></tr> <tr><td>(11)</td><td>170109</td><td>PROD DATE</td></tr> <tr><td>(21)</td><td>54086CNKC</td><td>SERIAL</td></tr> <tr><td>(240)</td><td>2015</td><td>MODEL</td></tr> <tr><td>(422)</td><td>840</td><td>ORIGIN US</td></tr> </table>	(01)	00386100002886	GTIN	(11)	170109	PROD DATE	(21)	54086CNKC	SERIAL	(240)	2015	MODEL	(422)	840	ORIGIN US	<p><b>MEDICA</b> <b>EasyLyte®</b></p> <p>Medica Corporation, 5 Oak Park Drive Bedford, MA 01730-1413 USA</p> <p>Emergo Europe, Molenstraat 15 NL-2513 BH The Hague, The Netherlands</p> <p>100-240 VAC 50/60 Hz 0.8 Amps Replace with fuse type: T0.8AL250V</p> <p>SN 54086CNKC</p> <p>2017-01-09</p> <p>GTIN 00386100002886 PROD DATE 170109 SERIAL 54086CNKC MODEL 2015 ORIGIN US 840</p> <p>Intertek 78559 Conforms to UL Std 61010-1 Certified to CSA Std C22.2 Nos. 61010-1, 61010-101 and 61010-081</p>
(01)	00386100002886	GTIN														
(11)	170109	PROD DATE														
(21)	54086CNKC	SERIAL														
(240)	2015	MODEL														
(422)	840	ORIGIN US														

## NHÃN PHỤ

<p><i>Tên hàng hóa:</i></p> <p><i>Mã sản phẩm:</i></p> <p><i>Số seri:</i></p> <p><i>Số lưu hành:</i></p> <p><i>HDSD tiếng Việt:</i></p> <p><i>Cảnh báo thận trọng và các thông tin khác:</i></p> <p><i>Nhà phân phối và bảo hành tại Việt Nam:</i></p> <p><i>Địa chỉ:</i></p> <p><i>Nhà sản xuất (chủ sở hữu):</i></p> <p><i>Địa chỉ:</i></p> <p><i>Xuất xứ:</i></p>	<p><b>Máy phân tích điện giải- EasyLyte</b></p> <p>2015</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Xem tài liệu HDSD đi kèm</p> <p>Đề nghị xem trong HDSD</p> <p><b>Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba</b></p> <p>Số 56- Ngõ 236 Khuong Đình- Hạ Đình- Thanh Xuân- Hà Nội</p> <p><b>Medica Corporation</b></p> <p>3 Oak Park Drive Bedford, MA 01730, USA</p> <p>Mỹ</p>
--	--

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**





**MEDICA**  
**EasyLyte®** CE IVD Store at 25°C  
REF 2014

Analyzer, Na/K/Cl 100-240 V 50/60 Hz  
Analizador, Na/K/Cl  
Analyseur, Na/K/Cl  
Na/K/Cl Analizörü  
Analizzatore, Na/K/Cl  
Analizador, Na/K/Cl  
Analysator, Na/K/Cl

Medica Corporation  
5 Oak Park Drive  
Bedford, MA 01730-1413 USA  
Emergo Europe, Molenstraat 15  
NL-2513 BH The Hague  
The Netherlands

EC REP

010610-003 RO

SN 54087CNKC 2017-01-09

(01) 00386100002879 GTIN  
(11) 170109 PROD DATE  
(21) 54087CNKC SERIAL  
(240) 2014 MODEL  
(422) 840 ORIGIN US

**MEDICA**  
**EasyLyte®** EC REP

Medica Corporation, 5 Oak Park Drive  
Bedford, MA 01730-1413 USA  
Emergo Europe, Molenstraat 15  
NL-2513 BH The Hague, The Netherlands

100-240 VAC 50/60 Hz 0.8 Amps  
Replace with fuse type: T0.8AL250V

SN 54087CNKC  
2017-01-09

(01) 00386100002879 GTIN  
(11) 170109 PROD DATE  
(21) 54087CNKC SERIAL  
(240) 2014 MODEL  
(422) 840 ORIGIN US

Intertek  
78559  
Conforms to UL Std 61010-1  
Certified to CSA Std C22.2  
Nos. 61010-1, 61010-101 and 61010-081

## NHÃN PHỤ

<i>Tên hàng hóa:</i>	<b>Máy phân tích điện giải- EasyLyte Plus</b>
<i>Mã sản phẩm:</i>	2014
<i>Số seri:</i>	.....
<i>Số lưu hành:</i>	.....
<i>HDSD tiếng Việt:</i>	Xem tài liệu HDSD đi kèm
<i>Cảnh báo thận trọng và các thông tin khác:</i>	Đề nghị xem trong HDSD
<i>Nhà phân phối và bảo hành tại Việt Nam:</i>	<b>Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba</b>
<i>Địa chỉ:</i>	Số 56- Ngõ 236 Khương Đình- Hạ Đình- Thanh Xuân- Hà Nội
<i>Nhà sản xuất (chủ sở hữu):</i>	<b>Medica Corporation</b>
<i>Địa chỉ:</i>	3 Oak Park Drive Bedford, MA 01730, USA
<i>Xuất xứ:</i>	Mỹ

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**

