

**CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ
VÀ VẬT TƯ Y TẾ
KHÁNH DUY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 1 năm 2022

HỒ SƠ VỀ KHO BẢO QUẢN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ KHÁNH DUY

MST: 0317110259

Công ty là đơn vị kinh doanh, phân phối trang thiết bị y tế có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số 153A đường số 6, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, cam kết có kho tàng bảo quản trang thiết bị đáp ứng các điều kiện:

- Có diện tích phù hợp với các chủng loại và số lượng trang thiết bị y tế được bảo quản;

- Vị trí, diện tích kho:

Diện tích: $8m \times 9.5m = 76m^2$

Vị trí kho: 153A đường số 6, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Nhà kho được thiết kế, xây dựng vững chãi, đảm bảo thoáng khí, khô ráo sạch sẽ, không gần các nguồn gây ô nhiễm

- Hệ thống điện 220V ổn định, đảm bảo các thiết bị điện năng trong kho hoạt động liên tục có điều hòa làm mát kho. Các thiết bị đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

CƠ SỞ CAM KẾT:

- 1/ Nội dung công bố là chính xác, hợp pháp và theo quy định. Nếu có sự giả mạo không đúng sự thật cơ sở xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và xử lý theo quy định của pháp luật.
- 2/ Đảm bảo chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.
- 3/ Thông báo Sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.



DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Số lượng	Tình trạng
Thiết bị vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa			
1	Xe đẩy hàng	01	Sử dụng thường xuyên
Thiết bị bảo quản, chiếu sáng			
1	Giá, kệ hàng	04	Sử dụng thường xuyên
2	Điều hòa	02	Sử dụng thường xuyên
3	Quạt điện	01	Sử dụng thường xuyên
4	Đèn chiếu sáng	8	Sử dụng thường xuyên
Thiết bị phòng cháy chữa cháy			
1	Bình xịt cứu hỏa	04	Sẵn sàng sử dụng
2	Phương tiện chữa cháy cơ bản (xô, chậu,..)	5	Sẵn sàng sử dụng
3	Bảng nội quy phòng cháy chữa cháy kho	01	Sử dụng thường xuyên
4	Tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy	01	Sử dụng thường xuyên
5	Bảng cấm lửa	01	Sử dụng thường xuyên
6	Bảng cấm hút thuốc	01	Sử dụng thường xuyên

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 1 năm 2022

Đại diện hợp pháp của cơ sở



Giám Đốc


Võ Thành Vinh



SƠ ĐỒ KHO

Tên cơ sở: **CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ KHÁNH DUY**

Địa chỉ: 153A đường số 6, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

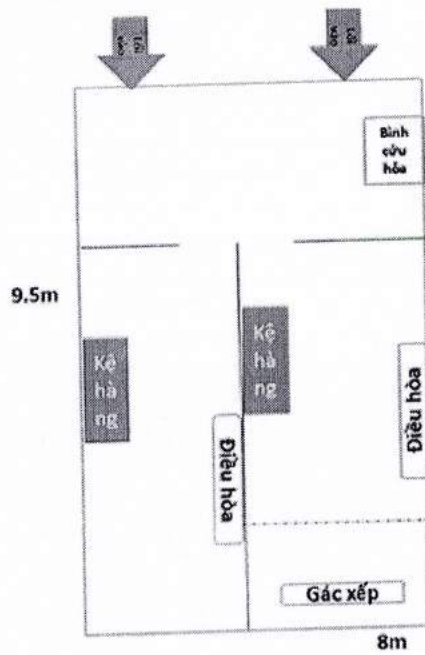

Đại diện pháp luật của cơ sở

Giám Đốc



Võ Thành Vinh

Tên Cơ Sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ KHÁNH DUY

Địa chỉ: 153A đường số 6, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BẢNG KÊ DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG TY CÔNG BỐ

STT	TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ	TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BẢO QUẢN ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT	NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN	PHƯƠNG TIỆN BẢO QUẢN
1	Máy tạo oxy		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
2	Đồng hồ đo khí oxy kèm bình làm ẩm		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
3	Máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
4	Monitor theo dõi bệnh nhân		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
5	Dao mổ điện, máy cắt đốt và các phụ kiện đi kèm		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
6	Máy xét nghiệm huyết học		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
7	Máy X – Quang		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
8	Máy siêu âm và phụ kiện đi kèm		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
9	Máy nội soi dạ dày, máy nội soi đại tràng, máy nội soi khí phế quản, máy nội soi tai mũi họng và các phụ kiện đi kèm		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
10	Máy soi cổ tử cung		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
11	Máy đo loãng xương		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
12	Hệ thống mổ nội soi phẫu thuật		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
13	Hệ thống làm ấm bệnh nhân phẫu thuật		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh



14	Máy đo độ vàng da, Đèn chiếu vàng da		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
15	Lồng ấp trẻ sơ sinh, Máy sưởi ẩm trẻ sơ sinh		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
16	Máy ly tâm		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
17	Máy vật lý trị liệu		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
18	Hệ thống khí y tế và các phụ kiện đi kèm (ô cấp khí gắn tường, trụ khí, dây dẫn khí, hộp đầu giường, các thiết bị ngoại vi như là Lưu lượng kế kèm theo cốc làm ẩm, Bộ hút dịch, Đầu cắm nhanh ...)		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
19	Thiết bị khử trùng dùng trong y tế, phẫu thuật (Ví dụ: máy hấp tiệt trùng; nồi hấp tiệt trùng; máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ plasma; đèn cực tím tiệt trùng, bồn rửa tay phẫu thuật...)		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
20	Huyết áp cơ, huyết áp điện tử		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
21	Các dụng cụ chỉnh hình hoặc đính, nẹp, vít xương		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
22	Máy đo nhĩ lượng		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
23	Máy đo thính lực		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
24	Bơm kim tiêm		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
25	Máy phân tích sinh hóa		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
26	Máy phá rung tim, tạo nhịp		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
27	Bơm tiêm điện, bơm truyền dịch		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
28	Máy phân tích khí máu		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
29	Lồng ấp trẻ sơ sinh		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh

30	Máy xét nghiệm nước tiểu		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
31	Máy xét nghiệm miễn dịch		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
32	Máy xét nghiệm điện giải		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
33	Máy xét nghiệm đông máu		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
34	Máy xét nghiệm HbA1c		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
35	Bộ thở oxy dòng cao qua mũi		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
36	Máy đo đường huyết kèm que thử		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
37	Bình hút dịch		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
38	Máy định danh vi khuẩn		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
39	Máy điều trị vết thương áp lực âm.		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
40	Dây truyền dịch		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh
41	Các TTBYT loại B, C, D khác		≤ 30 độ C (Nhỏ hơn hoặc bằng 30°C)	Quạt với máy lạnh

Note

Mỗi ngày sẽ theo dõi nhiệt độ kho qua nhiệt ẩm kế để có phương án điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh phù hợp với nhiệt độ bảo quản

