

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2022

### HỒ SƠ VỀ KHO BẢO QUẢN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở: HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC VÂN ANH

Địa chỉ: Số 393 Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ kho: Số 393 Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Về vị trí và diện tích kho:

- Có diện tích phù hợp với các chủng loại và số lượng trang thiết bị y tế được bảo quản .

- Diện tích sở hữu đất: 30 m<sup>2</sup> (4m x 7.5m)

- Vị trí: Số 393 Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Nam

#### 1. Các điều kiện của kho:

- Vị trí kho hàng đảm bảo thuận tiện cho việc vận chuyển, xuất nhập và bảo vệ, kho khô ráo sạch sẽ, không gần các nguồn ô nhiễm;

- Đáp ứng các yêu cầu bảo quản khác theo hướng dẫn sử dụng.

- Nền lát gạch, tường được sơn sạch sẽ

- Hệ thống điện 220V ổn định, đảm bảo các thiết bị sử dụng điện năng trong kho hoạt động liên tục. Các thiết bị đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ


- Nhiệt độ và độ ẩm được điều chỉnh theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

#### DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ


STT	Tên thiết bị	Số lượng	Tình trạng
<b>Thiết bị vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa</b>			
1	Xe đẩy hàng	01	Sử dụng thường xuyên
2	Xe máy	01	Sử dụng thường xuyên
<b>Thiết bị bảo quản, chiếu sáng</b>			
1	Giá, kệ hàng	04	Sử dụng thường xuyên
2	Điều hòa	01	Sử dụng thường xuyên
3	Quạt điện	02	Sử dụng thường xuyên
4	Đèn chiếu sáng	18	Sử dụng thường xuyên
<b>Thiết bị vệ sinh, phòng cháy chữa cháy</b>			
1	Chổi lau, chổi quét	01	Sử dụng thường xuyên
2	Nước rửa, xà phòng	01	Sử dụng thường xuyên
3	Thùng chứa nước sạch	01	Sử dụng thường xuyên
4	Khăn lau sạch	01	Sử dụng thường xuyên
5	Bình xịt cứu hỏa	01	Sẵn sàng sử dụng
6	Phương tiện chữa cháy cơ bản ( xô, chậu,..)	01	Sẵn sàng sử dụng
7	Bảng nội quy phòng cháy chữa cháy kho	01	Sử dụng thường xuyên
8	Tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy	01	Sử dụng thường xuyên
9	Bảng cấm lửa	01	Sử dụng thường xuyên
10	Bảng cấm hút thuốc	01	Sử dụng thường xuyên

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2022

**Đại diện hợp pháp của cơ sở**

  
Nguyễn Thị Thủy.

# SƠ ĐỒ MẶT BẰNG KHO

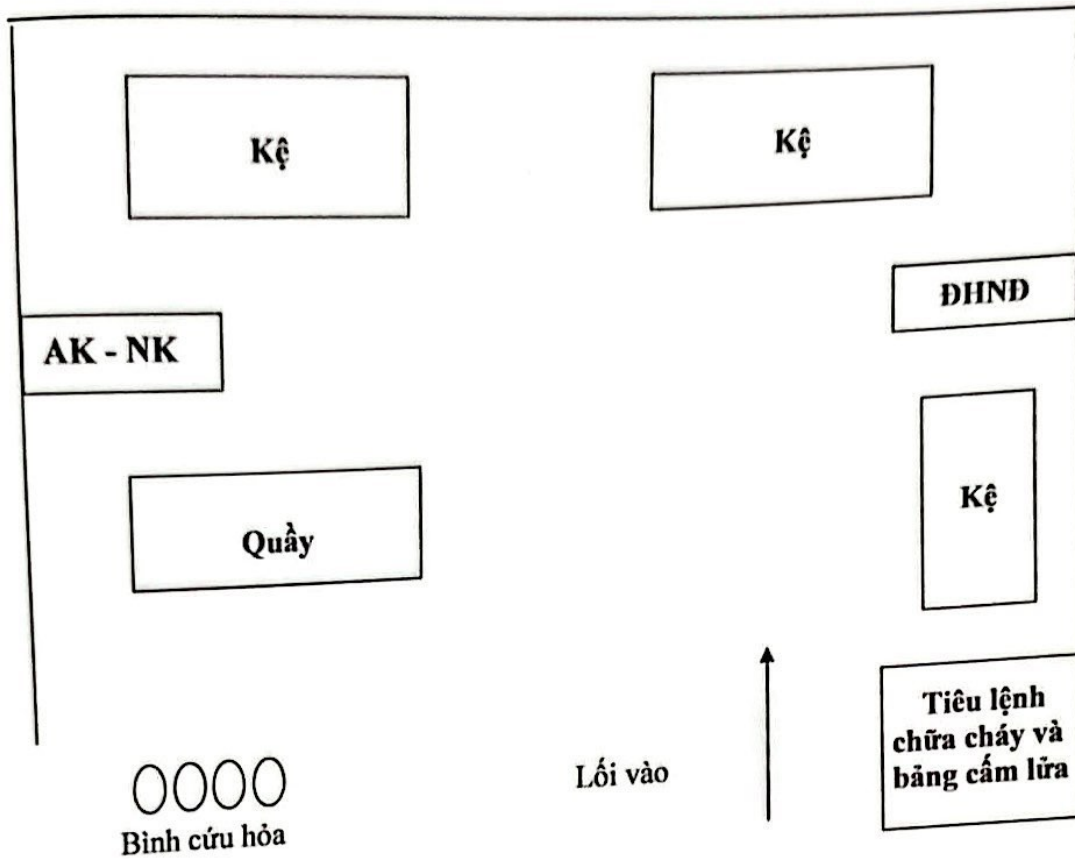

## MÔ TẢ KHO

- ĐHND: Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU
- Bình cứu hỏa: bố trí bên ngoài cạnh cửa ra vào kho
- NK, AK: Nhiệt kế, ẩm kế

○ Bình cứu hỏa

Đại diện hợp pháp của cơ sở

*Thủy*  
Nguyễn Thị Thủy.