

MẪU NHÃN

Tên cơ sở đăng ký lưu hành: **Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Kỹ thuật Lạc Tĩnh**
Địa chỉ: 849 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM

Ngày 16 tháng 05 năm 2022

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Phó giám đốc



Tổng Thị Bích Tuyên

NỘI DUNG NHÃN BẰNG TIẾNG VIỆT

Cốc đựng mẫu Sample Cups

Số lưu hành: xxxxx

Số lô: Xem **LOT** trên nhãn gốc

NSX: Xem  trên nhãn gốc

Bảo quản: Xem  trên nhãn gốc

Chủ sở hữu: Xem  trên nhãn gốc

Nước chủ sở hữu: Mỹ

Nước xuất xứ: Mỹ

Chủ sở hữu số lưu hành: **Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Kỹ thuật Lạc Tĩnh**
849 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM

SĐT: 028 37755740

Cảnh báo, Hướng dẫn sử dụng, Hướng dẫn bảo quản xin xem trên Hướng dẫn sử dụng tại:

www.xxxx.xxx



**Cốc đựng mẫu
Sample Cups**

Số lưu hành: xxxxx

Số lô: Xem **LOT** trên nhãn gốc

NSX: Xem  trên nhãn gốc

Bảo quản: Xem  trên nhãn gốc

Chủ sở hữu: Xem  trên nhãn gốc

Nước chủ sở hữu: Mỹ

Nước xuất xứ: Vương Quốc Anh

Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Kỹ thuật Lục Tỉnh
849 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM

SĐT: 028 37755740


Cảnh báo, Hướng dẫn sử dụng, Hướng dẫn bảo quản xin xem trên Hướng dẫn sử dụng tại:

www.xxxx.xxx

**Cốc đựng mẫu
Sample Cups**

Số lưu hành: xxxxx

Số lô: Xem **LOT** trên nhãn gốc

NSX: Xem  trên nhãn gốc

Bảo quản: Xem  trên nhãn gốc

Chủ sở hữu: Xem  trên nhãn gốc

Nước chủ sở hữu: Mỹ

Nước xuất xứ: Trung Quốc


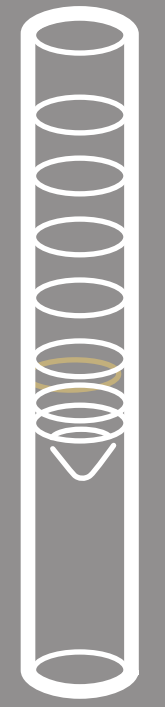

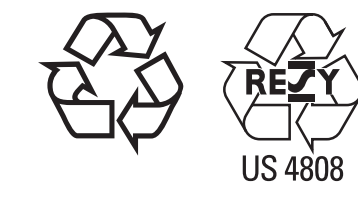









Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Kỹ thuật Lục Tỉnh
849 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM

SĐT: 028 37755740

Cảnh báo, Hướng dẫn sử dụng, Hướng dẫn bảo quản xin xem trên Hướng dẫn sử dụng tại:

www.xxxx.xxx

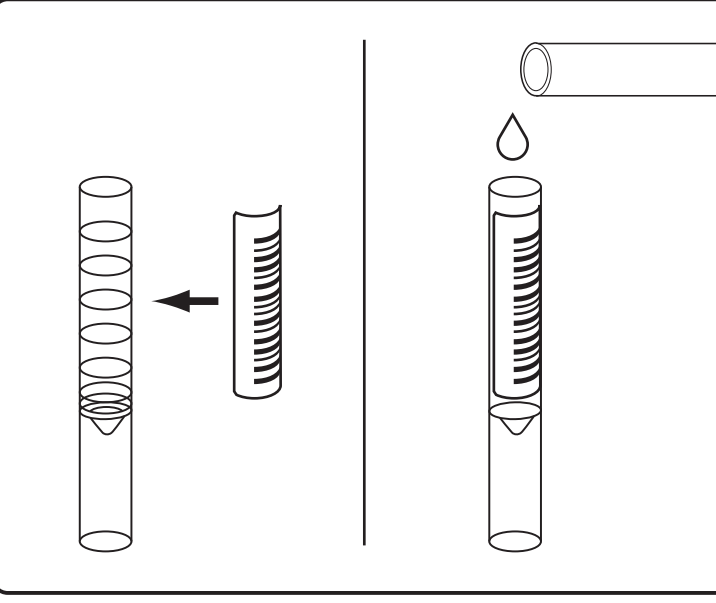

			
<div style="text-align: right;">  </div> <h2 style="text-align: center;">Sample Cups</h2> <p style="text-align: center;">3 x 500</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <small>For USA and Canada For use on ADVIA Centaur® systems</small> </div>  <h2 style="text-align: center;">SIEMENS</h2>	<div style="text-align: right;">  </div> <h2 style="text-align: center;">Sample Cups</h2> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> REF </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> LOT </div>  <h2 style="text-align: center;">SIEMENS</h2>	<div style="text-align: right;">  </div> <h2 style="text-align: center;">Sample Cups</h2> <p style="text-align: center;">3 x 500</p>   <h2 style="text-align: center;">SIEMENS</h2>	<div style="text-align: right;">  </div> <h2 style="text-align: center;">Sample Cups</h2> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> IVD i </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <small>Origin: <input type="checkbox"/> UK <input type="checkbox"/> US <input type="checkbox"/> CN Siemens Healthcare Diagnostics Inc. 511 Benedict Avenue Tarrytown, NY 10591 USA EC REP Siemens Healthcare Diagnostics Manufacturing Ltd. Chapel Lane Swords, Co. Dublin, Ireland US Pat D330,144</small> </div>  <h2 style="text-align: center;">SIEMENS</h2>
<p>11470598 Rev. 01</p>			