

MẪU NHÃN

THUỐC THỬ XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG HEMOGLOBIN TRÊN HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM ĐIỆN DI MAO QUẢN CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) BUFFER



Tên cơ sở đăng ký lưu hành: Công ty TNHH MediGroup Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Tp. HCM

Ngày 24 tháng 5 năm 2022


Mẫu nhãn lưu hành tại Việt nam sẽ gồm:

1. Nhãn phụ:


Tên sản phẩm	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Hemoglobin trên hệ thống xét nghiệm điện di mao quản
Chủng loại Mã sản phẩm	CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) BUFFER 2047
Số lưu hành
Tên và địa chỉ chủ sở hữu trang thiết bị y tế	Công Ty TNHH MediGroup Việt Nam Lầu 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Tp. HCM
Tên và địa chỉ chủ sở hữu trang thiết bị y tế	SEBIA Parc Technologique Léonard de Vinci, CP 8010 - Lisses - 91008 Evry Cedex – France
Xuất xứ	Pháp
Số Lô	Xem  trên nhãn gốc
Hạn sử dụng	Xem  trên nhãn gốc (ghi theo thứ tự năm-tháng-ngày hoặc năm-tháng)
Thông tin cảnh báo, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản và các thông tin khác	Tài liệu đi kèm theo trang thiết bị y tế hoặc vui lòng tham khảo website: www.medigroupasia.com

2. Nhãn gốc: vui lòng xem phụ lục đính kèm

ÉTIQUETAGE

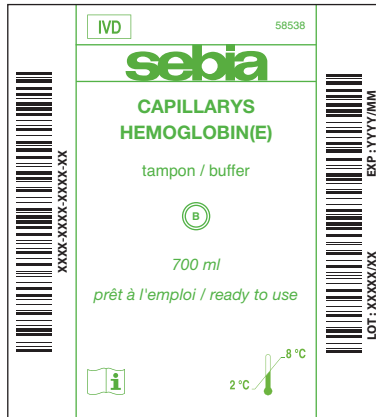

Tampon / Buffer

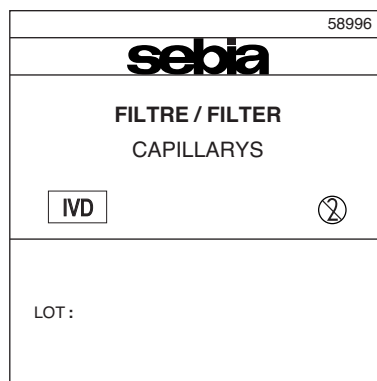

Filtre / Filter

sebia

PACKAGING
TAMPON CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E)
Réf. / PN 2047


Référence : FS/CDT/CH/2047
Indice : 12
Date d'application : 24 / 11 / 17
Page : 2/5

BOÎTE KIT




Face avant

BOÎTE KIT (suite)

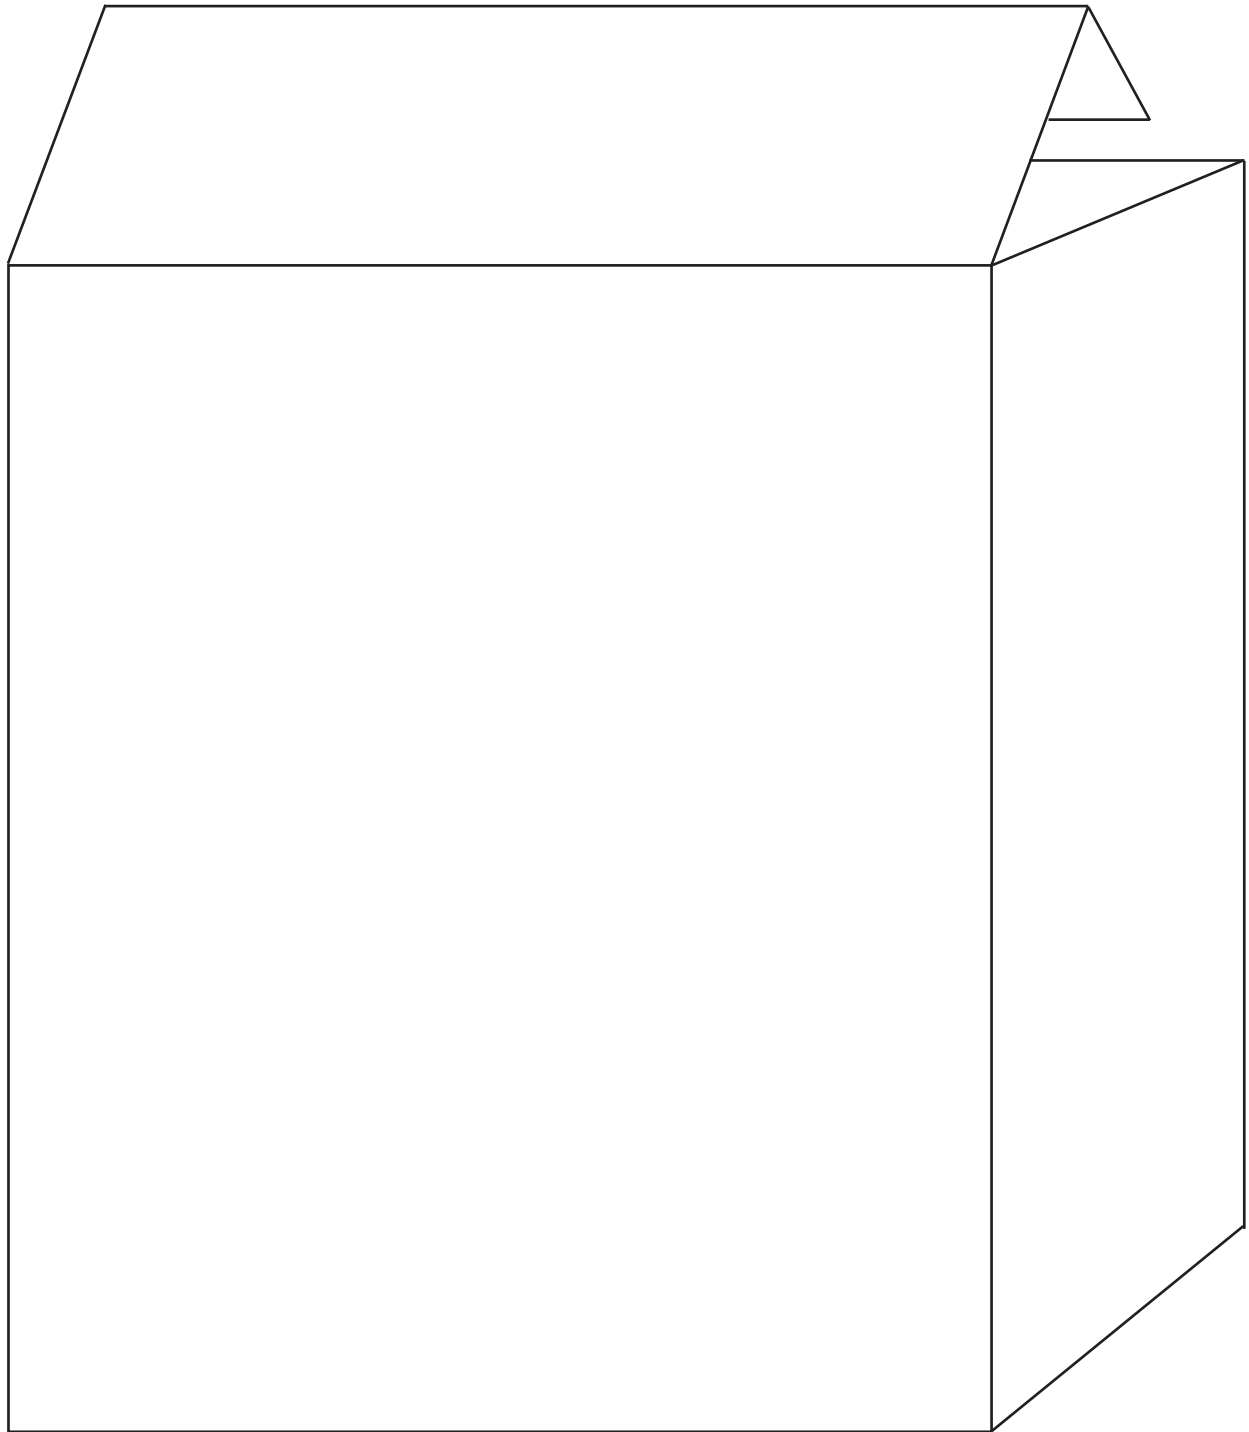


Face arrière

BOÎTE KIT (suite)

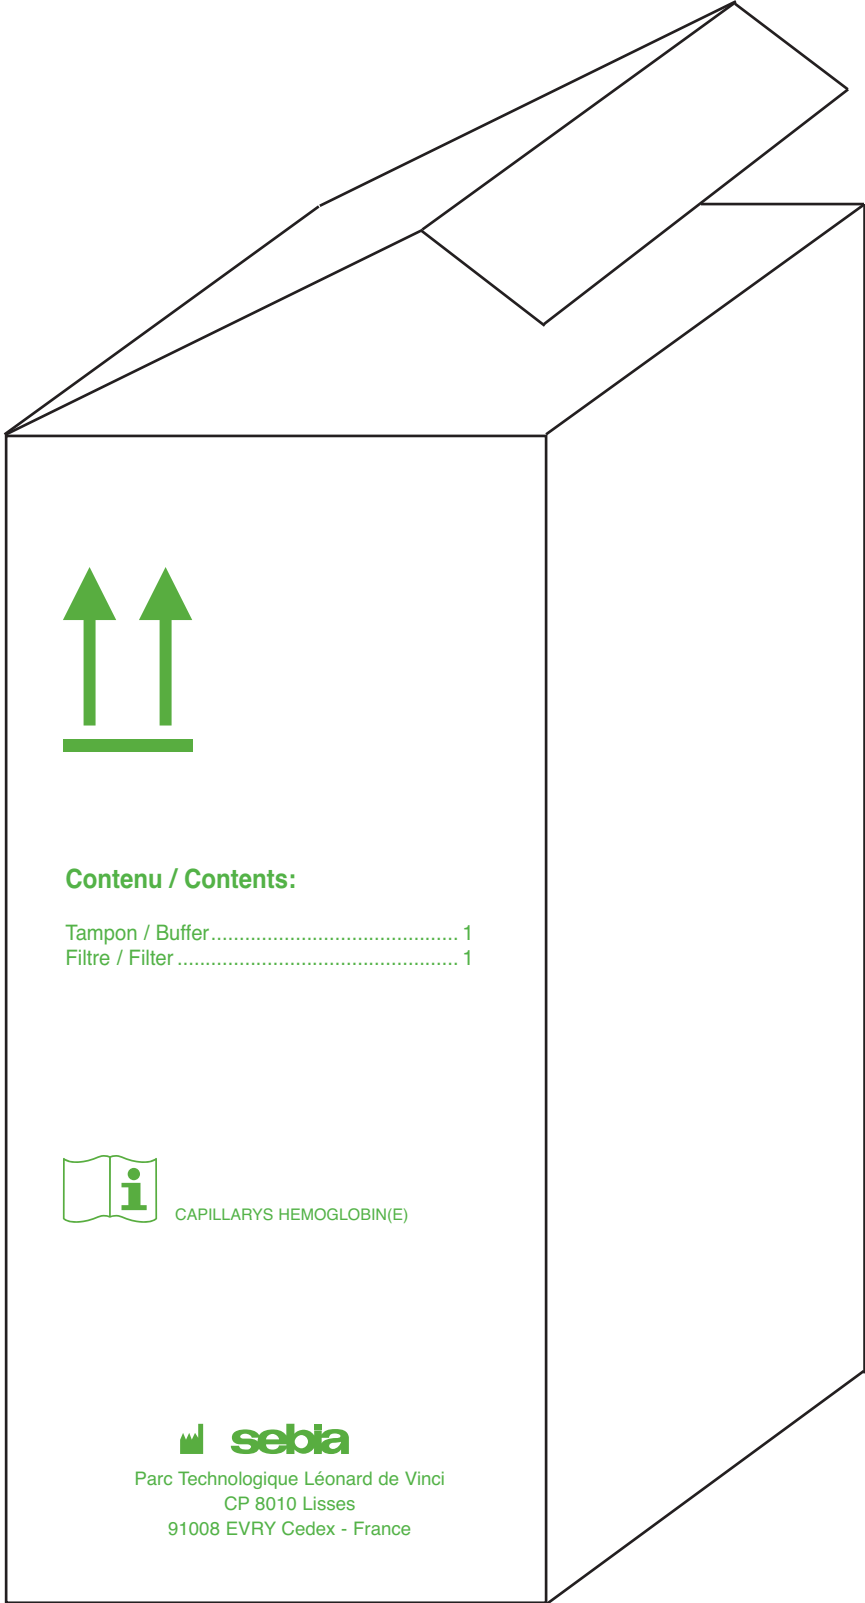

Côté gauche

BOÎTE KIT (suite)

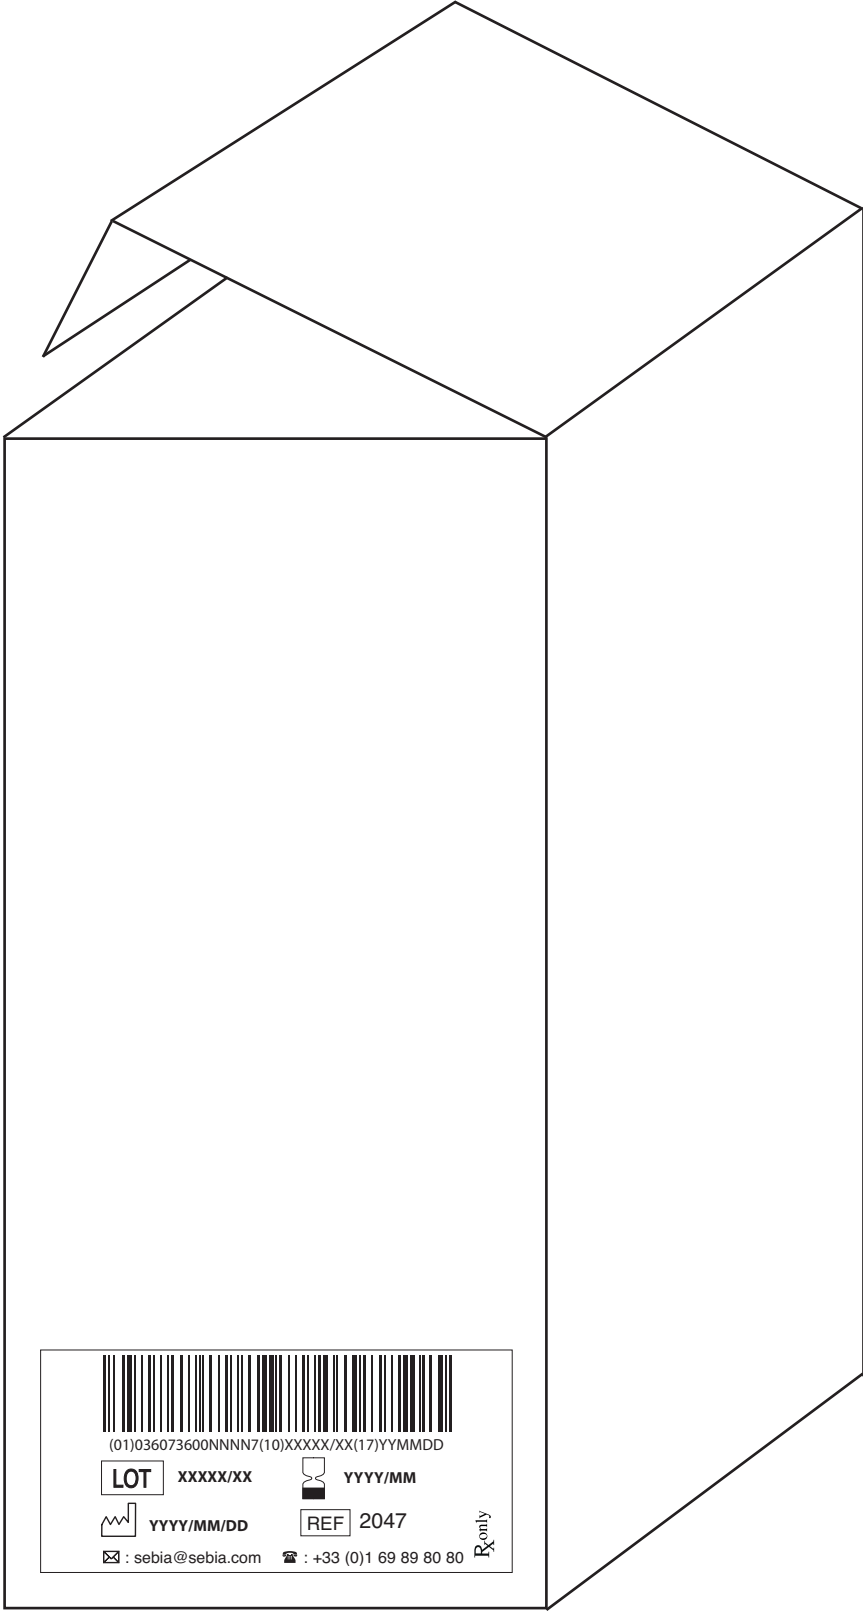

(01)036073600NNNN7(10)XXXXX/XX(17)YYMMDD

LOT	XXXXX/XX	YYY/MM
YYY/MM/DD	REF	2047

✉ : sebia@sebia.com ☎ : +33 (0)1 69 89 80 80 

Côté droit