


MẪU NHÃN SẼ SỬ DỤNG KHI LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

Tên trang thiết bị y tế: Bộ bơm bóng áp lực cao


Mẫu nhãn của Bộ bơm bóng áp lực cao

- ✓ Nhãn gốc (Nhãn ở hộp) : Kích thước (dài × rộng) : 13.9 cm × 6.5 cm

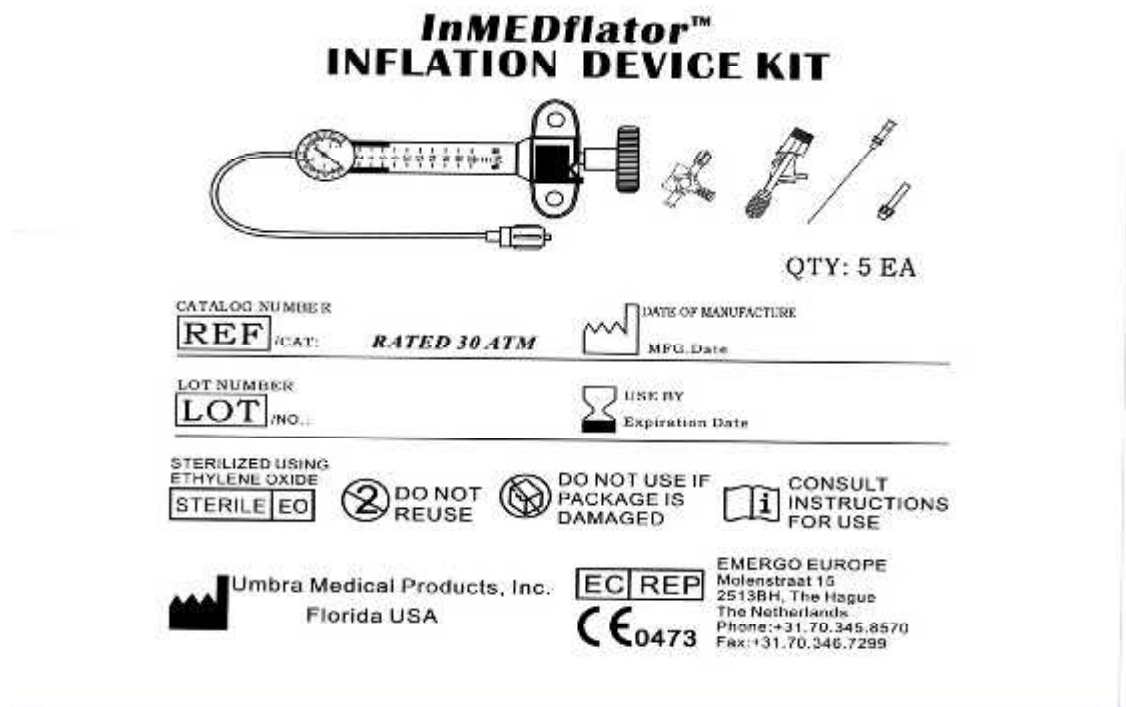

- ✓ Nhãn gốc (Nhãn ở hộp) : Kích thước (dài × rộng) : 13.9 cm × 6.5 cm

**InMEDflator™
INFLATION DEVICE KIT**

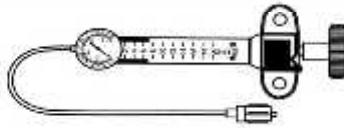

QTY: 1 EA

CATALOG NUMBER
REF / CAT.: **RATED 30 ATM**

LOT NUMBER
LOT NO.:

DATE OF MANUFACTURE
MFG. Date:

USE BY:
Expiration Date:

DO NOT REUSE
STERILIZED USING ETHYLENE OXIDE
STERILE EO

CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE
DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED

UMBRA MEDICAL PRODUCTS, INC.
Florida USA

CE 0473
EMERGO EUROPE
Molenstraat 15
2212BK, The Hague
The Netherlands
Phone +31 70 345 8570
Fax +31 70 346 7299

✓ Nhãn phụ : Kích thước (dài × rộng) : 7.5 cm × 7.0 cm

Tên trang thiết bị y tế: Bộ bơm bóng áp lực cao
Mã thiết bị:
Số lưu hành trang thiết bị y tế loại A:
Số lượng: 01 cái
Chất liệu: Nhựa Polycarbonate
Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing
 Phòng 101, tòa nhà Viễn Đông, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ
 Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Nhà sản xuất: Umbra Medical Products, Inc.
 8930 Roan Lane East Inverness, Florida 34450 USA
Xuất xứ: Mỹ
Ngày sản xuất :
Hạn sử dụng:
Số lot: Xem ký hiệu **LOT** trên nhãn gốc
Hướng dẫn sử dụng: Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo sản phẩm
Cảnh báo, thận trọng: Sản phẩm được đóng gói vô trùng. Chỉ sử dụng một lần. Chỉ sử dụng bởi bác sỹ có chuyên môn. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Bảo quản: Nhiệt độ phòng, nơi khô ráo, thoáng mát.



Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIAM ĐỐC
Nguyễn Thiên Trường