





NHÃN GÓC



1. Nhãn dán trên hộp

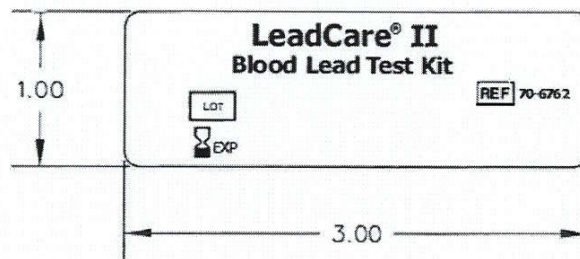

2. Nhãn bộ phận cảm biến

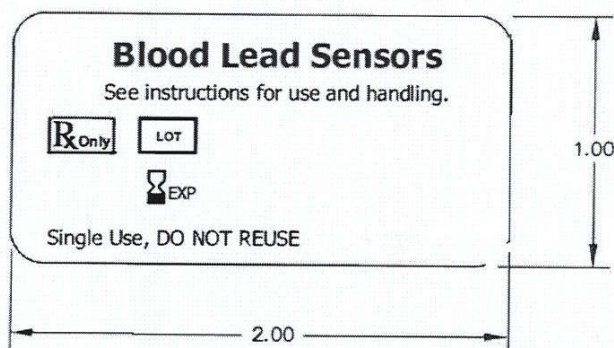


3. Nhãn ống thuốc thử

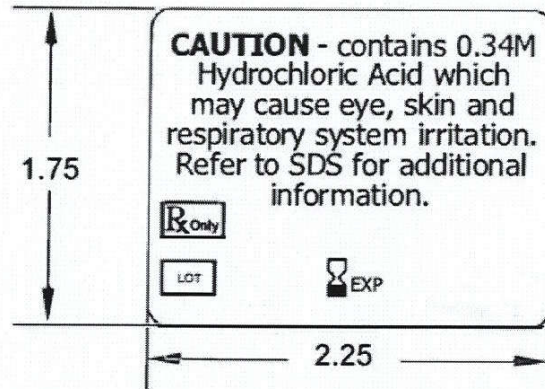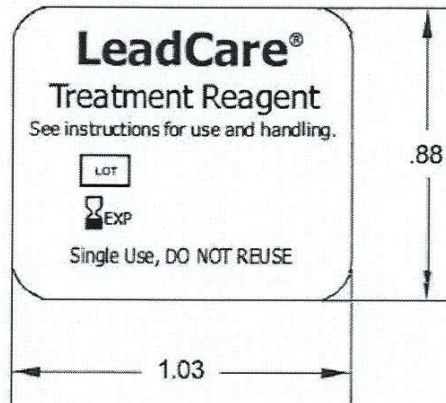


3778
NG T
HIỆM T
HÁP
I DƯ
NH -

4. Nhãn hộp ống mao dẫn/ Pít tông

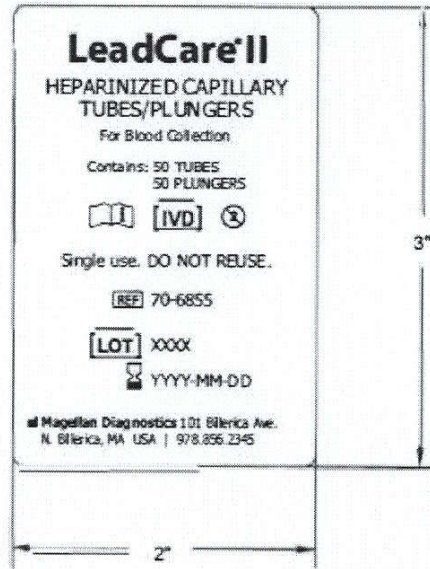

5. Nhãn hộp ống nhỏ giọt

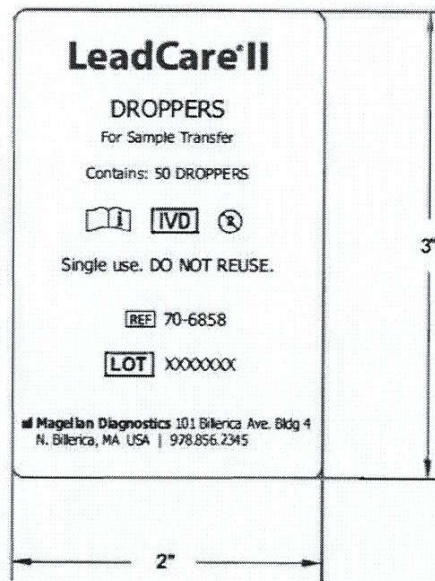

Y
DU HAN
HỒ
NG
PHAN

6. Nhãn lọ chứng mức 1

LeadCare® II Lead Control
Lot Number: XXXXX
Exp Date: XXXX-XX-XX
Level 1 Target: XX.X +/- X.X
Store at: 15 to 27 °C For Use With Sensor Lot XXXXX Only

7. Nhãn lọ chứng mức 2

LeadCare® II Lead Control
Lot Number: XXXXX
Exp Date: XXXX-XX-XX
Level 2 Target: XX.X +/- X.X
Store at: 15 to 27 °C For Use With Sensor Lot XXXXX Only





NHÃN PHỤ

Kit xét nghiệm chì LeadCare II

Số công bố tiêu chuẩn áp dụng: XXXX – YYY – ZZZ

Số lô: Xem trên bao bì

Mã REF: 70-6762

Hạn sử dụng: Xem  EXP trên bao bì

Nhà sản xuất: Magellan Diagnostics, Inc.

Địa chỉ: 101 Billerica Ave. Building 4, North Billerica, MA 01862, Mỹ

Chủ sở hữu lưu hành, NK, PP và Bảo hành: Công ty TNHH Giải pháp Khỏe Thái Dương

Địa chỉ: Số 8, ngách 112/59, Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

ĐKKD: 16 – LK 2, số 96 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.6285.4224 - 0903.430.936

Thông tin về bảo hành, HDSD và tài liệu kỹ thuật vui lòng xem tờ HDSD trong hộp